安寿（あんじゅ）

大切にしたい。
自立への気持ちと思いやり。

ポータブルトイレ
FX-CP〈ちびくまくん〉
快適脱臭取扱説明書

最大使用者体重：100kg以下

このたびはポータブルトイレFX-CP快適脱臭をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

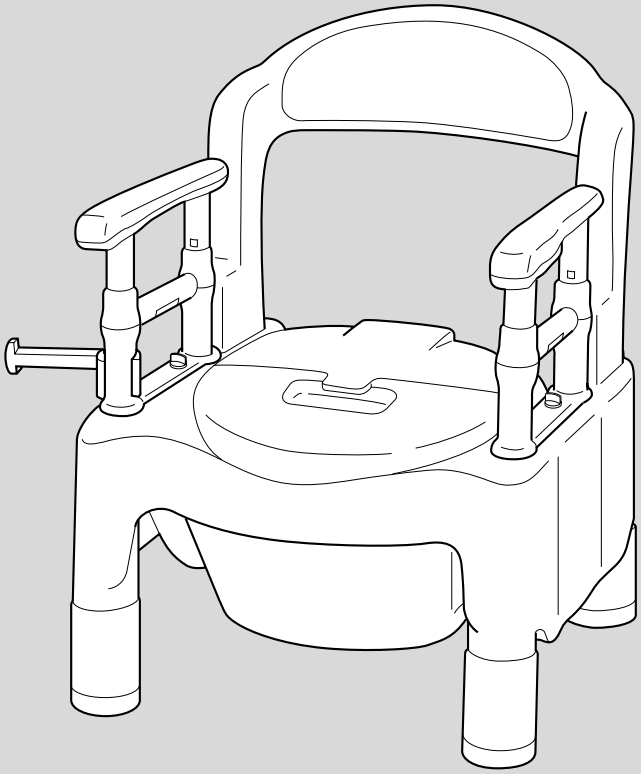

もくじ

安全上のご注意	1・2
各部のなまえ・特長	3
部材・付属品・特長	4・5
各機能の調整の目安	6~8
使いかた	9~15
お手入れの方法	15・16
故障かな？と思ったら	16

ARONKASEI CO.,LTD.

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。
⚠注意	誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。

してはいけない「禁止」内容を説明しています。

⚠ 警告

絶対に分解・修理・改造をしないこと
正常にはたらかず、けがの原因になります。

ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしないこと
感電の恐れがあり大変危険です。

ACアダプター・コードを破損するようなことをしないこと
傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないこと
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

ACアダプターは、根元まで確実に差し込むこと
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
●傷んだACアダプター、ゆるんだコンセントは、使用しないでください。

お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜くこと
感電やショートして火災の原因になります。

ACアダプターのほこり等は、定期的に取り除くこと
ACアダプターにほこりがたまると、湿気等で、絶縁不良となり、火災の原因になります。
●長期間使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。

⚠ 注意

背もたれやひじ掛けがしっかり固定されているか確認すること
身体が不安定な状態となり、けがの原因になります。

補高用脚が4本とも本体が安定する高さに設定されているか確認すること
補高用脚を固定ナットでしっかり止めているか確認すること
転倒し、けがの原因になります。

ひじ掛けの高さを調節した後、しっかりと固定されているか確認すること
転倒し、けがの原因になります。

各部の調節（高さ調節など）については、お買い上げの販売店かケアマネジャーなど専門家に相談すること

使用者の身体状況によっては、介助者が付き添ったり、お買い上げの販売店かケアマネジャーなど専門家に相談すること

安全上のご注意

⚠ 注意

使用者が用便等の際、自分自身の身体を十分に安定させられない場合は、介助者が必ず付き添うこと

上蓋の開閉は、必ず持ち手部を持って行うこと
別の部分を持って行うと指をはさむ原因になります。



必ず平たんな場所で使用すること

ねじ類がゆるんでいないか、定期的に点検すること
不安定になり、けがの原因になります。

ACアダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずACアダプターを持って引き抜くこと

直射日光が当たる場所や火気に近づけないこと
火災や変形の原因になります。



上蓋やひじ掛けの上に立ったり座ったりしないこと
転倒し、けがの原因になります。



背もたれを手すりがわりに持たないこと
転倒し、けがの原因になります。

子供・幼児を遊ばせる等、他の用途では使用しないこと

体重が100kgを超える方は使用しないこと
本体が破損する恐れがあります。

バケツの中に水や汚物を入れたまま、本体を移動させないこと
内容物がこぼれ、服や床などを汚す恐れがあります。

脱臭器は、水洗いしないこと
脱臭器の内部に水が入ると故障の原因になります。

脱臭器に小便や水をかけないこと

脱臭器の排気口に物や手を入れないこと
回転するファンにまきこまれ、けがの原因になります。また、ファンの故障の原因になります。

落としたり、強い衝撃を与えないこと
故障、破損をする恐れがあります。

センサーを引っ張らないこと
故障の原因になります。
●持ち運ぶときは、センサーやセンサーコード、ふただけを持たずに、必ず脱臭器の本体を持ち、センサーに手をそえて持ってください。



専用のACアダプター以外は使用しないこと
故障の原因になります。

お手入れの際は、タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール、殺虫剤等は絶対に使用しないこと
プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。

各部のなまえ

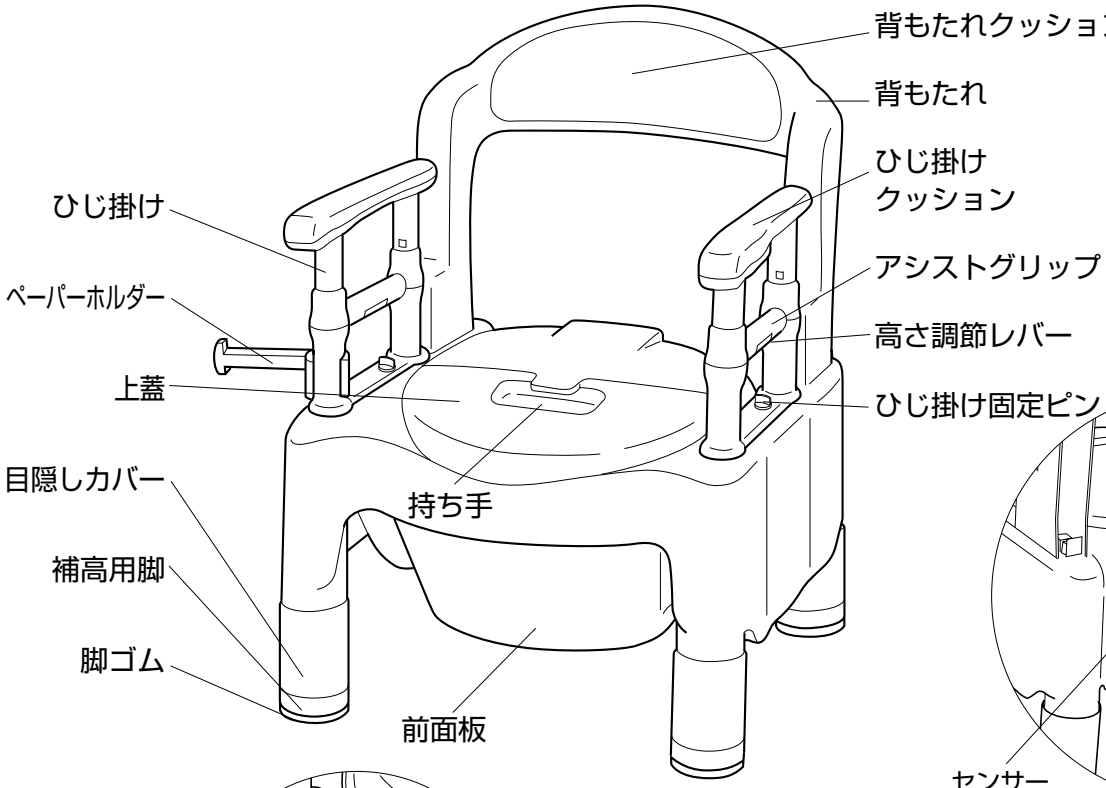

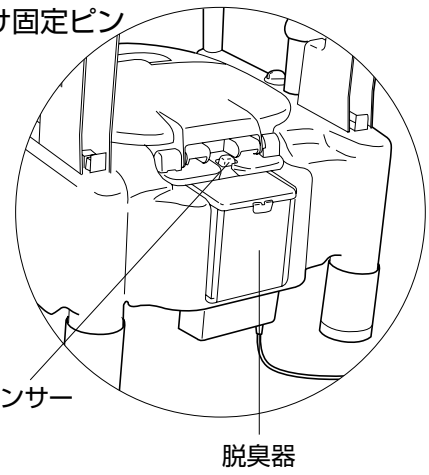

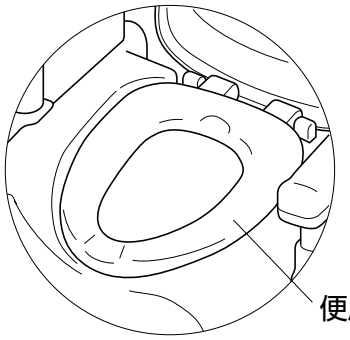

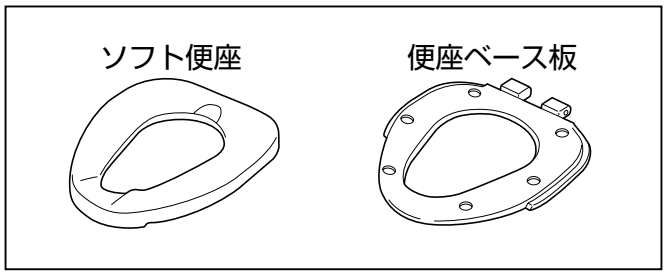

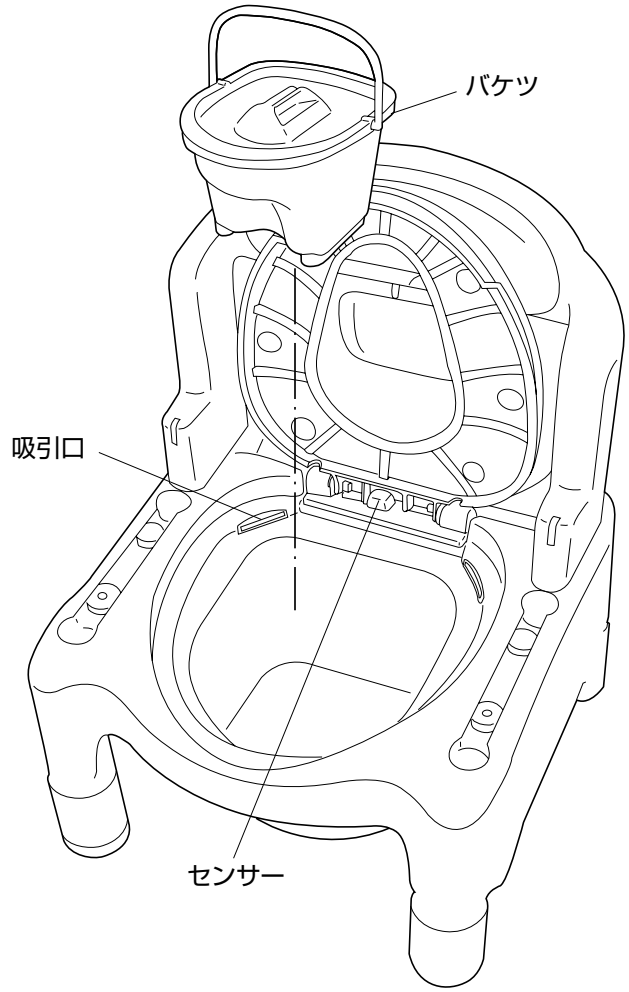

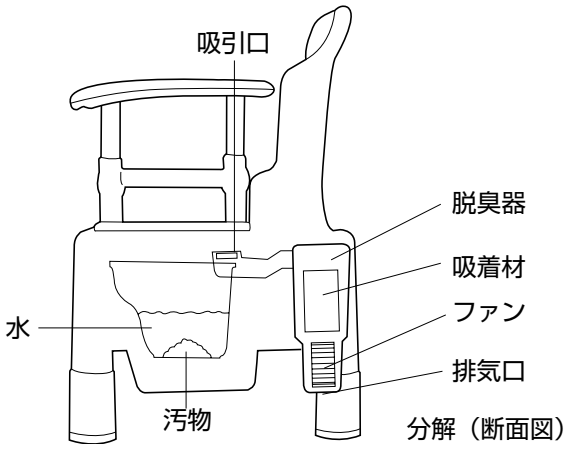

分解（断面図）

部材・付属品

部材



●本体１台



●ひじ掛け（左・右）各1本

●ひじ掛け穴カバー１個



●ペーパーホルダー１個



●背もたれ固定ピン2個



●背もたれ１個



●ひじ掛け固定ピン
2本



●補高スペーサー4個



●ACアダプター　1個

センサー

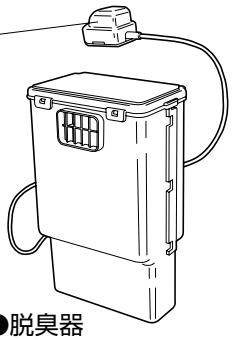

●脱臭器

以下の部材は、ご購入時には、ポータブルトイレ本体に
組み込まれています。

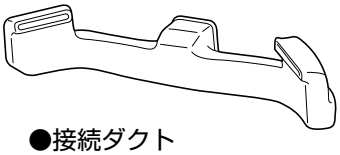

●接続ダクト



●プレフィルター

付属品
●防臭消耗品
（消臭剤フォームタイプ　1本）

※暖房便座については別紙「暖房便座取扱説明書」をご参照ください。

品名　ポータブルトイレ FX-CP　快適脱臭		
	ポータブルトイレ　本体	脱臭器
材質	本体・上蓋・便座ベース板 バケツ・アシストグリップ上 背もたれ・ペーパーホルダー 補高用脚・補高スペーサー　} ポリプロピレン ひじ掛け・アシストグリップ下：ABS 背もたれ・ひじ掛けクッション：EVA 脚ゴム：スチレン系エラストマー ソフト便座：発泡ポリエチレン（抗菌加工）	本体：ポリプロピレン 接続ダクト：ポリエチレン プレフィルター：ポリウレタン 吸着材：触媒配合ハニカム活性炭
寸法	幅55×奥行55×高さ71～83cm （便座までの高さ　33～40cm ※補高スペーサー使用時38～45cm）	幅13.5×奥行9.5×高さ22.1cm
重量	約11kg	約0.7kg
バケツ容量	約10ℓ	ー
電源	ー	AC100V（50/60Hz共用） DC12V（ACアダプター使用）
消費電力	ー	約5W
脱臭方法	ー	吸着脱臭方式
吸着材寿命	ー	約7年（1日1時間使用した場合）
動作	ー	人体を感知し自動的に起動 最終感知から5分後に停止
コード長	ー	約1.9m

特長

ポータブルトイレ本体

●便座までの高さを症状・体形に合わせて33～45cm（40～45cmの調節は補高スペーサーを使用）に調節可能です。（無段階調節）
●本体側面にも足を入れるスペースがあり、側方介助する際に腰に負担がかかりにくい親切設計です。
●ひじ掛けは、高さを 5 段階に調節可能。（便座から18・21・24・27・30cm）症状や使い勝手に合わせて、座位保持・立ち座り・排泄姿勢など、最適の高さを選択できます。
●ひじ掛けにはアシストグリップが付いているので移乗時に体を引き寄せたり、着座時に体を安定させたりなど、便利な使い方を選べます。
●ひじ掛け間の幅を 2 段階から選択可能です。（内寸38cm、41cm）
　上体の不安定な方や、本体の安定性を増したい場合は、ひじ掛け内寸を狭くして使用してください。
●上蓋は手首を返すことなく開閉できるユニバーサル構造の折りたたみ式です。
●ソフト便座には、着座時の痛みや冷たさを緩和するやわらかい素材を使用しています。（抗菌加工）
●ソフト便座が汚れた時は、分解して洗えます。
●バケツの下に汚水受けを設けた二重構造なので、飛散した小水を便器外に漏らさないクリーン構造です。
●ペーパーホルダーはひじ掛けの支柱にお好みの角度で取り付け可能です。

快適脱臭

●吸引構造
　便座の下後方2ケ所の吸引口から、臭いを強力に吸い取ります。
●自動運転
　センサーが、ポータブルトイレに近づく人に反応して自動で運転を開始します。また、人がはなれてから、約5分後に停止するタイマー付きです。
●吸着材
　吸着材は、触媒配合ハニカム活性炭で、1日1時間の使用で約7年間使用することができます。

各機能の調節の目安

●使用される方の体格・症状・使用目的に合わせて、さまざまな調節ができます。

※下記事項は、調節の目安です。
　調節をするときは、お買い上げの販売店やケアマネジャーなど専門家に相談することをおすすめします。

ひじ掛けの高さを調節する

ひじ掛けの高さは18～30㎝まで5段階に調節できます。

1）ひじ掛けのみで立ち上がる場合

着座時のひじの高さよりも低めにすると立ち上がりやすくなります。

（目安）

身長	150㎝	160㎝	170㎝
ひじ掛けの高さ	18㎝	21㎝	24㎝

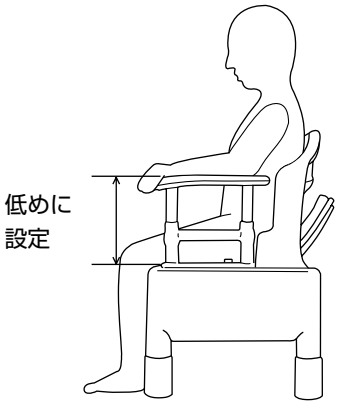

2）移動用バー等を持って立ち上がる場合

着座時の安定と前傾した際の排泄姿勢を安定させるため、高めに設定します。

（目安）

身長	150㎝	160㎝	170㎝
ひじ掛けの高さ	24㎝	27㎝	30㎝

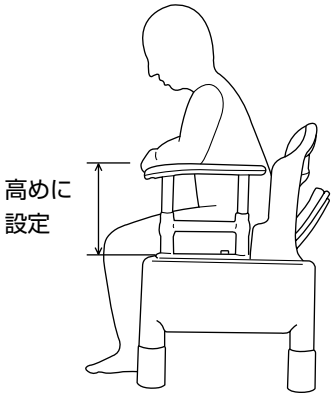

※ひじ掛けを高くすると

①アシストグリップを持って、着座姿勢が安定します。

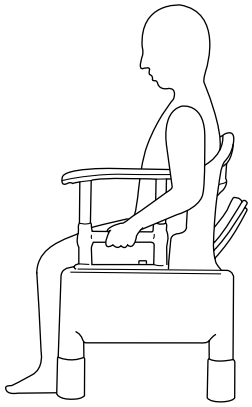

各機能の調節の目安

②後ろ向きで着座する際、立ったままひじ掛けを確認することができます。

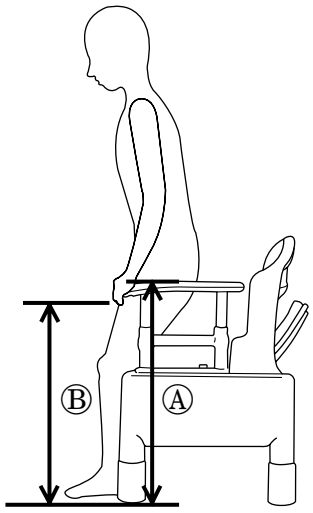

（目安）

身長	150㎝	160㎝	170㎝
Ⓐ床から ひじ掛けまで	59㎝	65㎝	70㎝
Ⓑ直立姿勢での 床から指先まで	57㎝	62㎝	66㎝

3）座位で移乗する場合

片ひじ掛けの高さを、少し高めにすると姿勢が安定します。

（目安）

身長	150㎝	160㎝	170㎝
ひじ掛けの 高さ	24㎝	27㎝	30㎝

移乗時にアシストグリップを握ると、身体の引き寄せ、引き離しがしやすくなります。

便座の高さ調節

便座の高さは33～45㎝まで無段階に調節できます。

1）立位で移乗する場合

便座の高さを下腿長の高さで座ると、姿勢が安定します。

（目安）

身長	150㎝	160㎝	170㎝
便座高	35㎝	38㎝	40㎝

※膝関節が痛く立ち座りを重視する場合は便座高を＋4㎝程度高くしてください。

2）座位で移乗する場合

マットレスのつぶれ分を見越し、ベッド高さより少し低くして設定します。

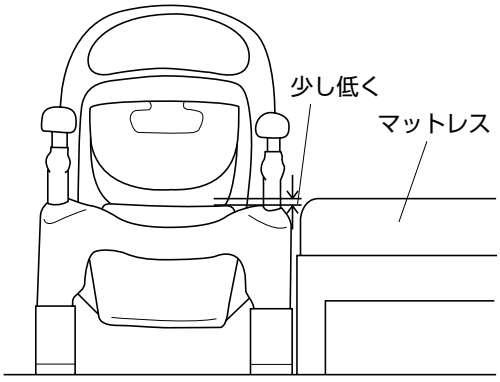

各機能の調節の目安

補高スペーサーの使いかた

補高スペーサーは便座の高さを40～45㎝まで調節できたり、ポータブルトイレを安定させたい時に使用します。

1）片側のひじ掛けのみに身体をあずけて移動する場合は、トイレが動いたり、傾いたりして転倒の危険があるので、補高スペーサーを取り付けると、安心して移動が行えます。

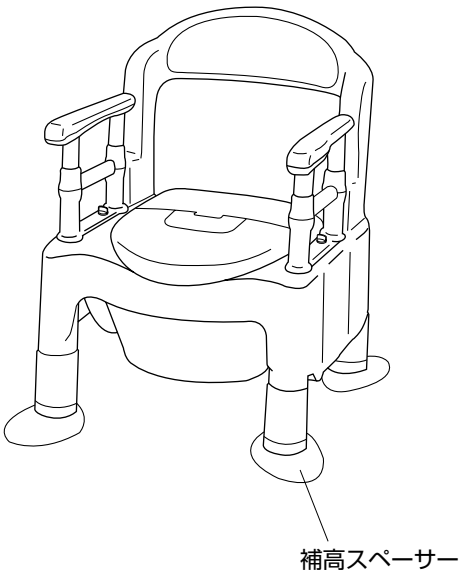

※便座高は38～45㎝に設定できます。

例）

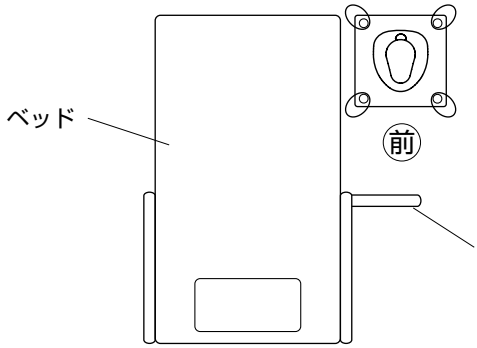

補高スペーサーを斜め45度の方向に取り付けた場合

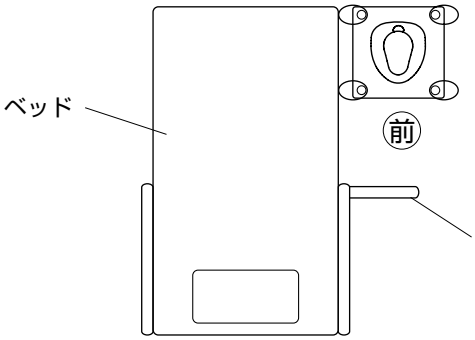

補高スペーサーを横に向けて取り付けた場合

※リウマチや膝関節症の方など、着座時の反動でトイレが後方へ傾く恐れのある場合は補高スペーサーを後ろ方向に向けて取り付けると安定します。

例）

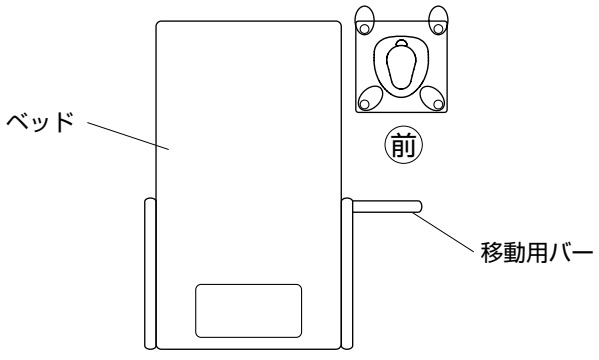

各部の調節は、取扱説明書の使いかたに従い調節してください。

使いかた

組立て方法

1 背もたれを固定する

①背もたれクッションのある方を前面にして取付穴にはめ込みます。
②背もたれの両支柱の後側から背もたれ固定ピンで、左右２ヵ所しっかり固定します。
※背もたれを取り外す場合は、逆の手順で行ってください。

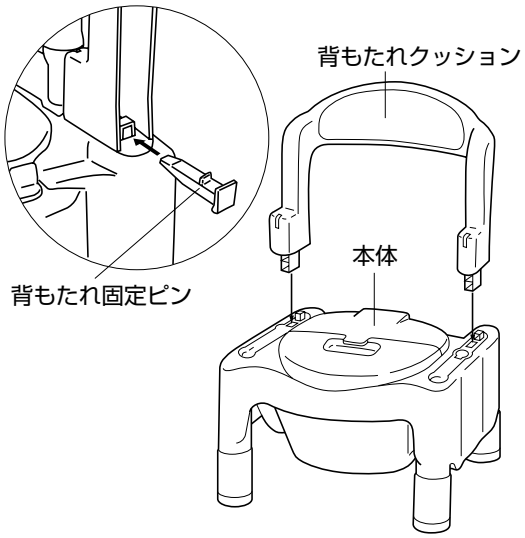

> ⚠ 注意
> **背もたれ固定ピンで背もたれを必ず固定すること**
> 背もたれが外れ、不安定になり、けがの原因になります。

2 ひじ掛けを固定する

ひじ掛けを固定する前に

ひじ掛けの内寸は使用される方の体格と症状に合わせて38・41cmの2種類を選択することができます。

38cmに設定する場合

ひじ掛けの天面が途中から広くなっている方を内側にして固定します。



41cmに設定する場合

ひじ掛けの天面が途中から広くなっている方を外側にして固定します。



ひじ掛けの固定はひじ掛けクッションの先端が幅広くなっている側を前面にして、本体と背もたれの溝にはめ込みます。
ひじ掛けの穴にひじ掛け固定ピンを差し込み、90°回転させて固定します。

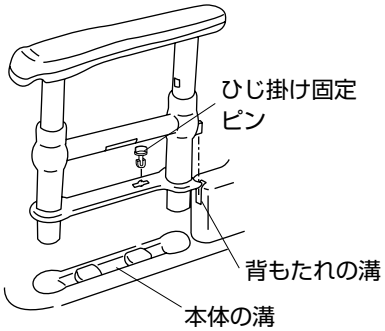

> ⚠ 注意
> **ひじ掛けはひじ掛け固定ピンで必ず固定すること**
> ひじ掛けが外れ、不安定になり、けがの原因になります。

使いかた

3 ひじ掛けの高さを調整する

ひじ掛けの高さは、5段階〈18・21・24・27・30cm〉に調節できます。
調節の方法は以下の手順に従って行ってください。

①設定したいひじ掛けの高さを決めます。
②ひじ掛け中段のアシストグリップの下側にある高さ調節レバーを下方へしっかり引っ張り、ひじ掛けグリップ部をもって、上下に動かしながら、設定したい高さ（ひじ掛け支柱の目盛りに合わせて）にひじ掛けを合わせます。

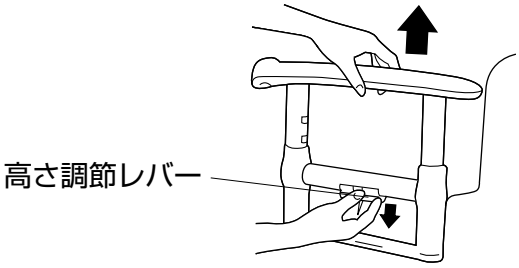

●24cmに設定の場合

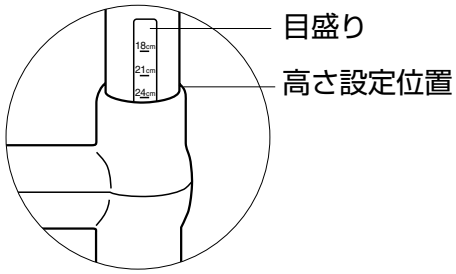

③高さ調節レバーを元の位置に戻し、ひじ掛けを少し上下に動かすと、カチッという音がして、ひじ掛けが固定されます。

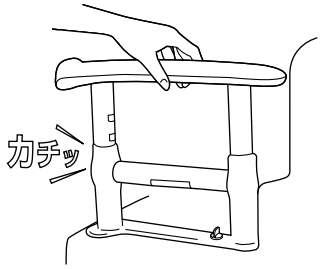

④最後に、ひじ掛けがしっかりと固定されていることを確認して完了です。

> ⚠ 注意
> **ひじ掛けの高さを調節した後、しっかりと固定されてるか確認すること**
> 転倒し、けがの原因になります。

4 便座の高さを調節する

便座の高さは、通常33～40cm、補高スペーサーを使用することで最大45cmまで調節することができます。調節の方法は以下の手順に従って行ってください。

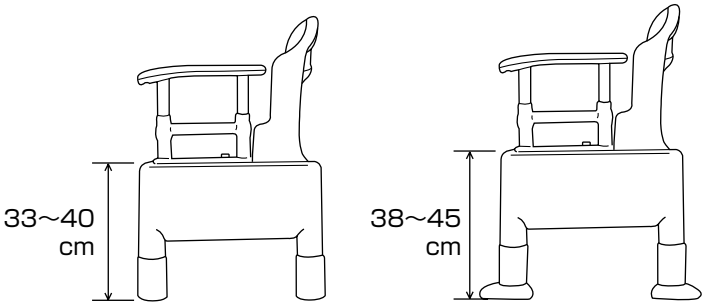

通常　　補高スペーサを使用した場合

※補高スペーサーは、身体の安定を保てない方が使用される場合や、本体をしっかり安定させたい方にも便利です。

使いかた

通常の高さ調節の場合

（便座までの高さ：33～40cm）
①まず補高脚目隠しカバーを上にスライドさせます。
②固定ナットをゆるめます。
③3本の補高用脚を右に回しながら目盛りで調節し、残りの１本はトイレを使用する場所で安定感を確認しながら調節します。
④補高用脚は固定ナットでしっかり止めてください。
※補高用脚には１cmごとに目盛りがついていますので、脚の高さをそろえる目安にしてください。

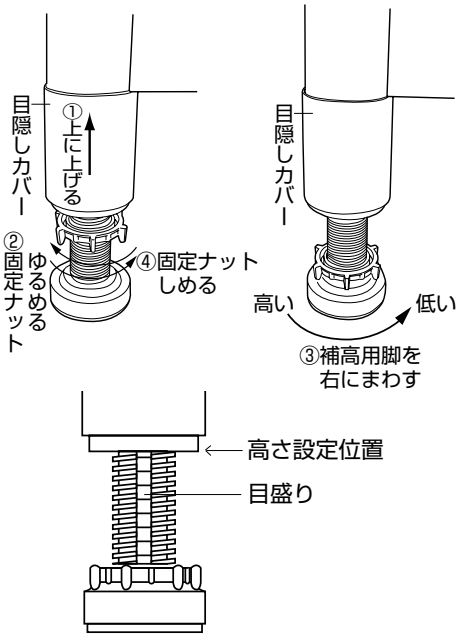

注意

補高用脚は本体が安定する高さに固定され、固定ナットでしっかり止められているか確認すること
転倒し、けがの原因になります。

補高スペーサー（5cm）を使用して高さ調節を行う場合

通常の①～④の高さ調節方法に従って、本体の補高用脚を設定します。高さ設定の目安は、設定したい高さ－5cmの高さに補高用脚を設定します。

	補高用脚の高さ	補高スペーサーを取り付けた時の高さ
便座の高さ（目安）	33	38
	・	・
	35	40
	・	・
	38	43
	40	45

補高スペーサーの取り付けかた

①補高用脚裏面の脚ゴムを取り外します。
②補高スペーサーの裏面に①で取り外した脚ゴムをはめ込みます。
③補高スペーサーの固定軸を補高用脚裏面の穴に奥まで差し込みます。
④P7「補高スペーサーの使いかた」を参考にしながら、補高スペーサーの向きを調節してください。

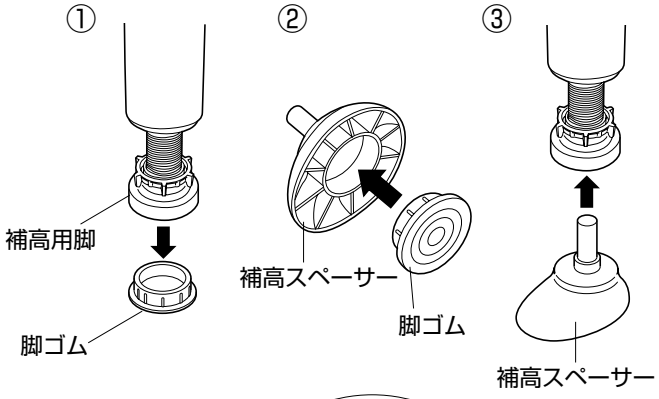

5 ペーパーホルダーをつける

ペーパーホルダーはひじ掛けの支柱にお好みの角度で取りつけることができます。
使いやすい位置に取りつけて、トイレットペーパーをセットしてください。

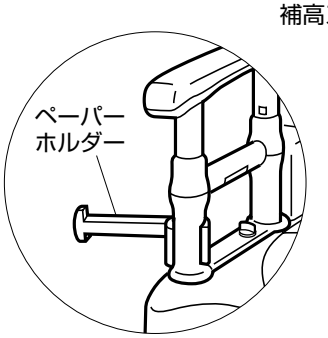

注意

ペーパーホルダーにはトイレットペーパー以外のものは掛けないこと

6 脱臭器の使いかた

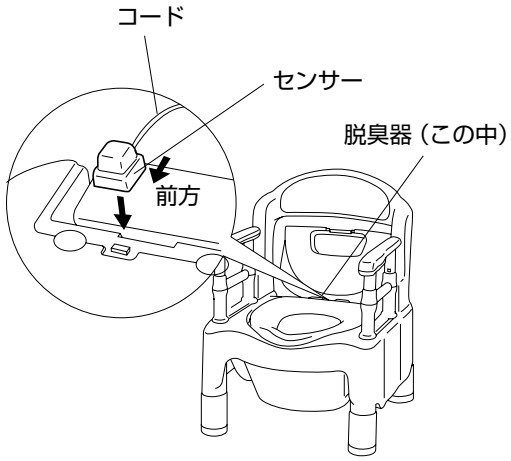

①脱臭器はポータブルトイレ本体の後方（便座・上蓋の後方）に収納されています。

②脱臭器本体とコード線でつながった白い部品が、センサーです。センサーが、便座・上蓋軸受下に取りつけられていることを確認してください。外れている場合は、図の向きを参考に、マジックテープで固定されるように取りつけてください。

③接続ダクトと脱臭器がしっかり接続されているか確認してください。外れている場合は、本体裏からダクトを押え脱臭器の口と合わせて差し込んで下さい。

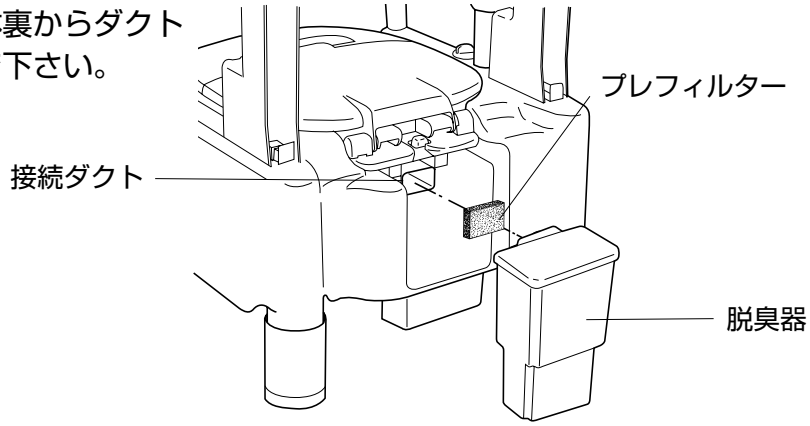

⚠ 注意

接続ダクトはしっかり接続してあることを確認すること。また、異物等を挿入したりはさみ込まないこと

吸引力を低下させたり、故障の原因になります。

④ACアダプターの端子を脱臭器本体の底にあるジャック穴に差し込み、ACアダプター本体を、家庭用（100V 50/60Hz）コンセントに差し込んでください。約30秒後、センサーが待機状態となり、人体を感知すると、脱臭器が運転を開始します。

⑤センサーは、人体を感知し続けると運転を継続しますが、人体を感知しなくなってから、約５分後に運転を停止します。ご使用中に脱臭器が停止した場合はセンサー部に手をかざして再起動させてください。

（脱臭器の中には、触媒配合ハニカム活性炭の吸着材が入っており、悪臭を吸着して取り除きます。吸着材の寿命は、1日1時間の使用で約7年です。）

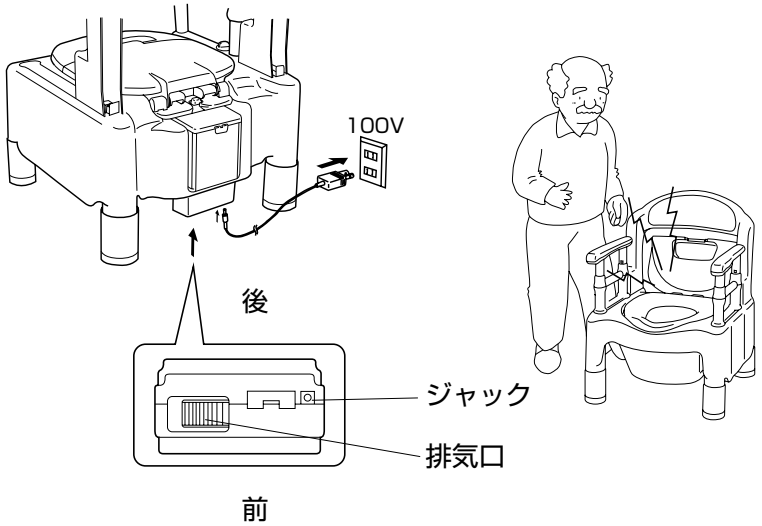

使いかた

7 快適な使い方

本製品には、防臭消耗品が入っています。ご活用いただき、
快適にお使いください。

①防臭消耗品の使い方
バケツに約2ℓの水（バケツ内側の2と表示のある線まで）を入れ、
消臭剤フォームタイプを入れておくと泡が臭いをしゃ断します。

快適脱臭の場合は、付属の消臭剤フォームタイプを併用することにより、
自動停止後も長時間脱臭効果が持続します。

> ⚠ 注意
> **当社指定の防臭消耗品以外は使用しないこと**
> 脱臭器の吸着材は、臭いの成分を吸着するため、香料を含む薬剤を使用すると、吸着材の寿命が短くなる恐れがあります。

②便器に座る前に用便されてしまう場合もあります。あらかじめ
ポータブルトイレ用消臭・防水シート（別売）を敷いておくと、
より快適にお使いいただけます。

③上蓋を開け、便座を上げて、バケツの蓋を外してご使用ください。
※バケツ内へは、ティッシュペーパーなど、トイレットペーパー以外のものは入れないこと。
トイレで処理する際、詰まる原因になります。

④使用後はポータブルトイレ本体からバケツを取り出して、汚物をトイレに流してください。

ベッド等から移乗する場合。
ベッド側のひじ掛けを外し、その位置にひじ掛け穴カバーを取り付けてお使いください。尚、移乗後、上体の安定を保ちたい場合は、ひじ掛け穴カバーを外し使いかたの2にしたがい、ひじ掛けを固定してください。
※ひじ掛けは、どちらか　片方を必ず取り付けてお使いください。

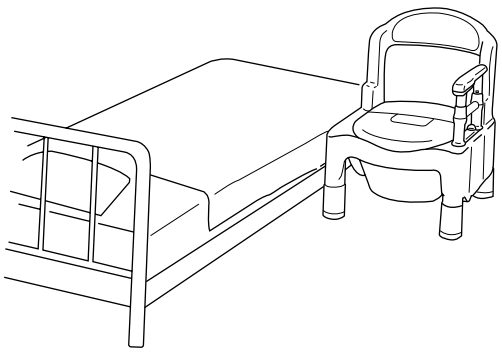

使いかた

上蓋、便座の分解・組立て方法

●お手入れや便座の取りかえを行う時

1 上蓋・便座を本体からはずす

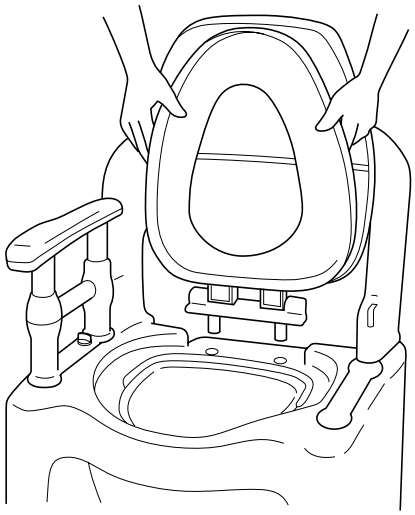

2 軸受裏の軸カバーのツメをつまみながら、軸カバーをはずす

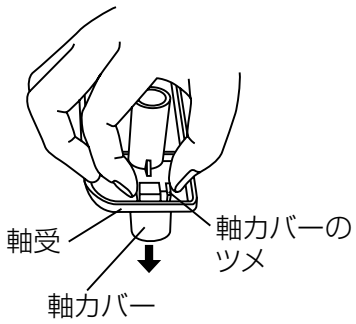

3 止めピンをぬき、上蓋・便座を軸受けからはずす

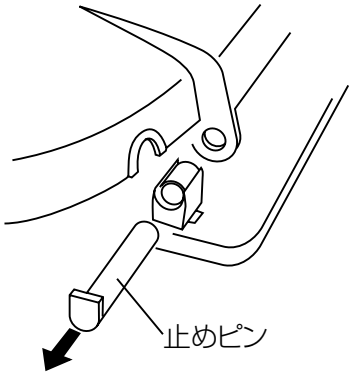

4 最後に上蓋の軸穴からオイルダンパーをぬき、上蓋と便座を分解する

（オイルダンパーが軸受に残った時は、4の作業はいりません）
※組立てる場合は、4から逆の手順で行ってください。

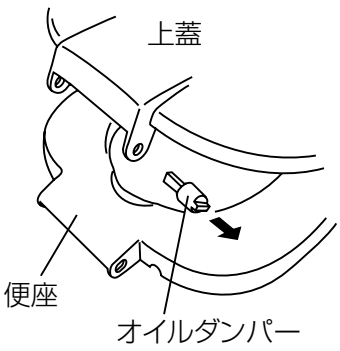

使いかた

ソフト便座仕様はソフト便座と便座ベース板に分解できます。

裏面の凸部を押して分解してください。

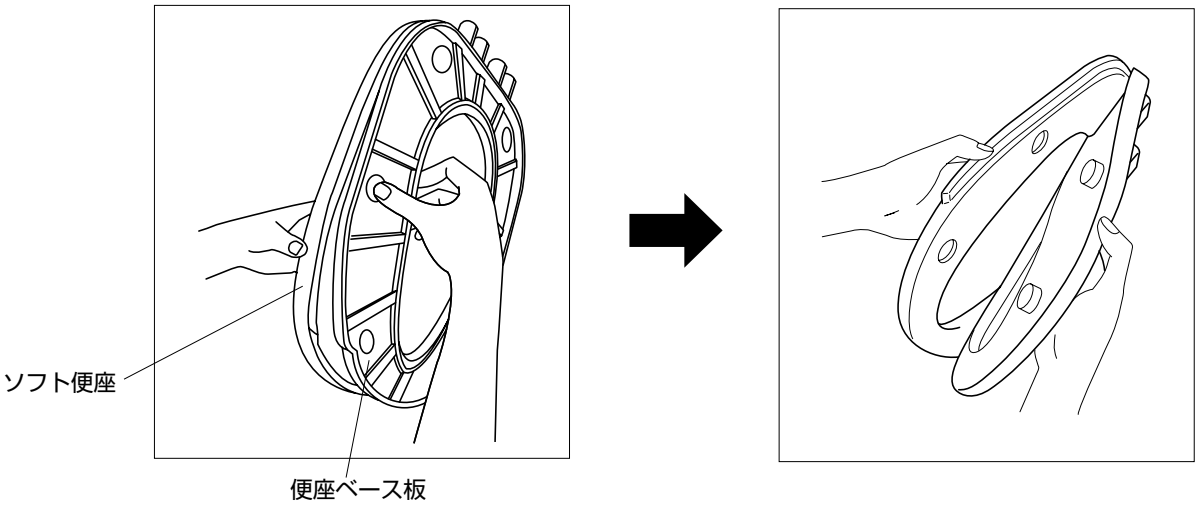

注意

ソフト便座と便座ベース板に分解する際、無理に引っぱらないこと
強く引っぱると、ソフト便座が破損します。

お手入れの方法

1 普段のお手入れは

いつまでも気持ちよくお使いいただくために、小マメに汚れを落してください。
汚れはスポンジかやわらかい布に、中性洗剤のうすめ液をふくませてふきとってください。

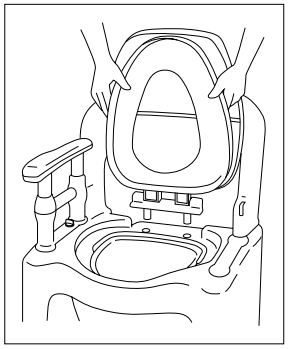

2 少しひどい汚れには

上蓋・便座は、本体から取り外すことができます。汚れがひどくなった時は、上蓋・便座の分解・組み立ての方法 〈P.14〉 の手順に従い取り外してください。

注意

※お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜くこと
感電やショートして火災の原因になります。
※脱臭器は水洗いしないこと
水洗いする場合は、必ず脱臭器をポータブルトイレ本体から取り外すこと
脱臭器の内部に水が入ると故障の原因になります。

注意

※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
※塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと
※ひじ掛けのお手入れは、住居用洗剤、シンナー、アルコール等は絶対に使用しないこと
プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。

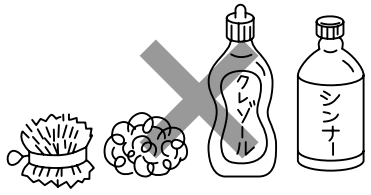

お手入れの方法

3 脱臭器のお手入れ

①ACアダプターを取り外し、上蓋・便座を本体から取り外します。次にセンサーをポータブルトイレ本体から外してください。

②脱臭器をポータブルトイレ本体から引き上げ取り外してください。

③ダクトは、汚れやほこりが溜りやすいので、時々ブラシ等で、ほこりを取り除いてください。また、落ちにくい汚れは、水で洗い流してください。

④接続ダクトと脱臭器の間にあるプレフィルターは、ほこりがたまりやすいので、月に１度は取り外して、やわらかいブラシ等でほこりを取り除いてください。

⑤脱臭器の取り付けは、脱臭器をポータブルトイレ本体後方の穴に差し込み、脱臭器の口と接続ダクトの口を合わせて差し込んでください。
最後にセンサーの向きに注意しながら本体にセンサーを取り付け、便座・上蓋を本体にセットし、完了です。（12ページ参照）

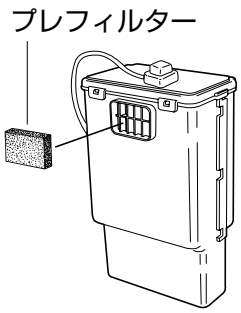

⚠ 注意

センサーコードを引張ったり、折り曲げたりしないこと
断線して故障の原因になります。

故障かな？と思ったら

●修理などを依頼される前に、本書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

こんなとき	調べるところ・原因・対策
においが取れない	・脱臭器を取り外し、プレフィルターのお手入れをしてください。 ・ポータブルトイレ本体の吸引口、脱臭器排気口をふさいでいるものがないか、確認してください。また、排気口に手をかざして、風が排気されていることを確認してください。 ・接続ダクト・脱臭器がしっかり接続されているか、確認してください。
センサーに手などをかざしても作動しない	・センサーが汚れていませんか。 ・脱臭器・コンセントにACアダプターをしっかり差し込んでください。また２～３回抜き差しをくり返してから、しっかり差し込んでください。
人がいないのに作動し続ける	・上蓋が開いていませんか？開いていると、センサーが近くの人を感知する場合があります。使用しないときは、上蓋を閉めてください。